


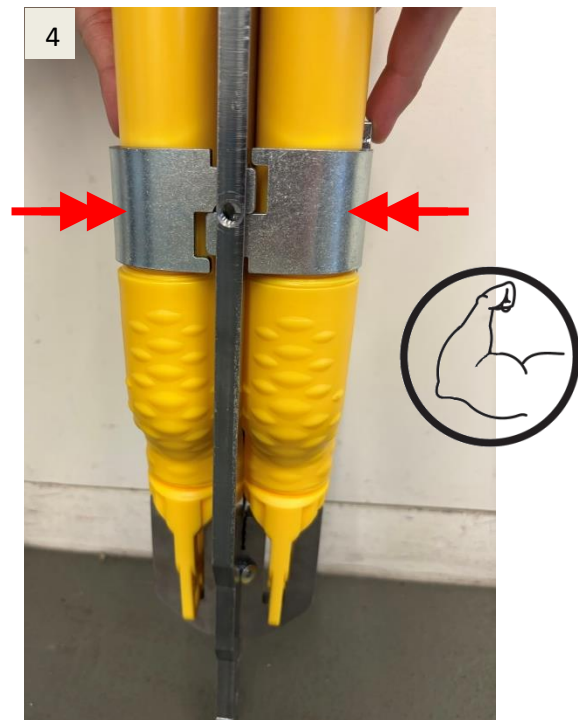
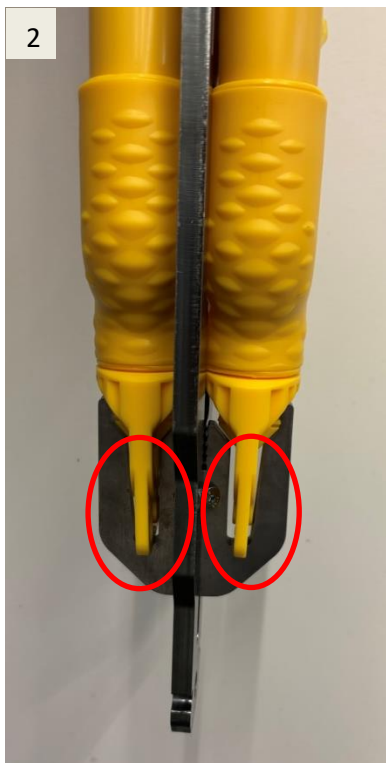
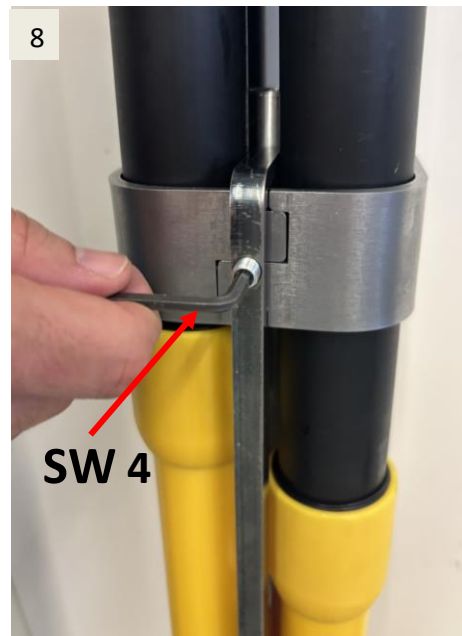


Montageanleitung GEROtherm® PUSH-FIX FLUX für Doppel-U
Assembly instructions GEROtherm® PUSH-FIX FLUX pour Double-U
Instructions de montage GEROtherm® PUSH-FIX FLUX for Double-U

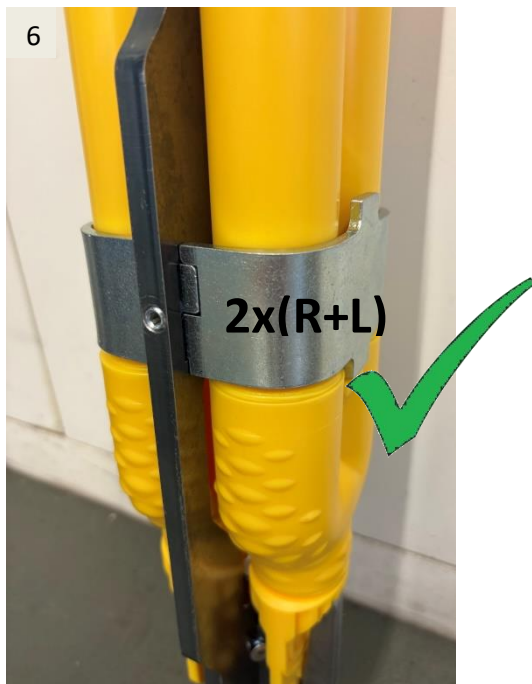

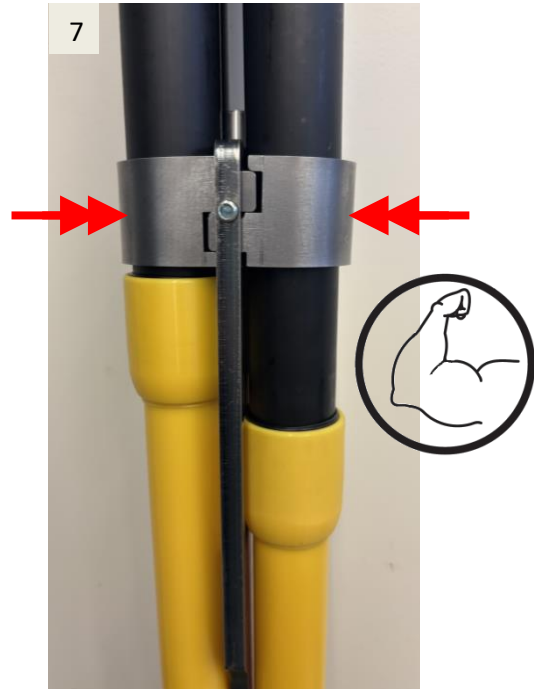

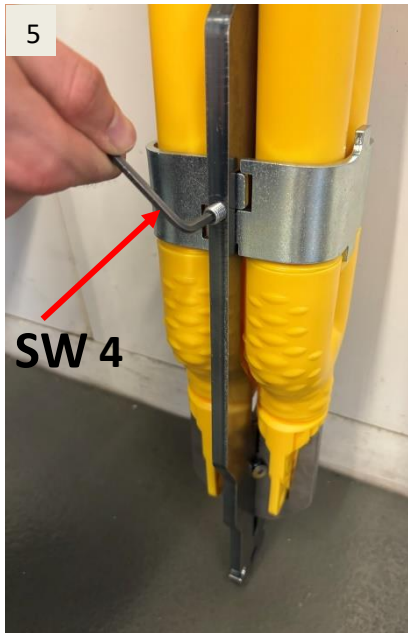

Hinweis: Die Nutzung des GEROtherm® PUSH-FIX setzt eine gleichmässige, gerade Abteufung voraus. Seitliche Hindernisse, Kavernen oder Verkantungen des Sondenfusses können nicht in jedem Fall zielgenau überwunden werden.

Note: The use of the GEROtherm® PUSH-FIX requires an even, straight sinking of the geothermal probe. Lateral obstacles, caverns or tilting of the probe base cannot always be overcome accurately.

Remarque: L'utilisation du GEROtherm® PUSH-FIX nécessite une descente uniforme et droite. Les obstacles latéraux, les cavernes ou les porte-à-faux du pied de la sonde ne peuvent pas être surmontés avec précision dans tous les cas.